





Verein für medizinische Qualitätskontrolle  
Association pour le contrôle de Qualité médical  
Associazione per il controllo di qualità medico

# Cobas pulse

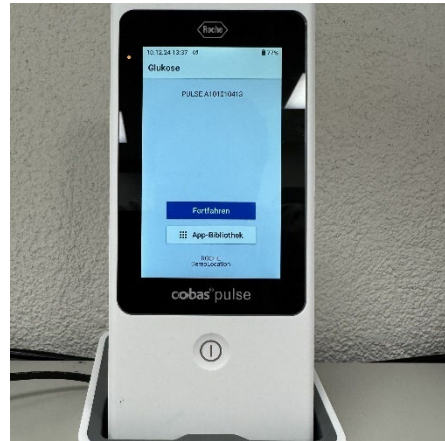

Analisi	Campione	Modalità
Glucosio	K01/K02/Flacone con contagocce	Controlli circolari

-  Invertire i campioni di siero/plasma 5 volte (non agitare).  
È possibile scansionare o immettere qualsiasi cosa come ID del campione.